

Geleidingswaardemeting


De verkregen waarde geeft aan welke basistherapie gekozen moet worden uit het BICOM[®] computerhandboek. De geleidingswaardetest stelt de algemene energetische toestand van de patiënt vast en is behulpzaam bij de vaststelling van een basistherapie.

Schakeling en methode zijn als volgt:

1. Apparaat inschakelen en E-toets indrukken.
2. Met het EAP testgedeelte kan reeds getest worden, als in het display de basispositie verschijnt.
3. De patiënt krijgt in elke hand een cilindrische handelektrode.
4. Eén handelektrode is aan de blauwe kabel van het testbestek aangesloten.
5. De andere handelektrode is niet aangesloten.
6. Met de testgriffel de handelektrode aanraken, die zeker niet aan een kabel aangesloten is.
7. Hierdoor beweegt de wijzer van de meetklok naar boven en toont de waarde aan.

De waarde bedraagt binnen de norm 80 tot 86 schaaleneheden. Voor de EAP-test moet de richtwaarde rond 80 liggen, anders geven alle overige geteste acupunctuurpunten een te hoge of te lage waarde. Als de test onder 80 ligt kan deze in dit geval op 80 gebracht worden, door een opbouwende therapie toe te dienen.

Vaststellen van de testwaarde

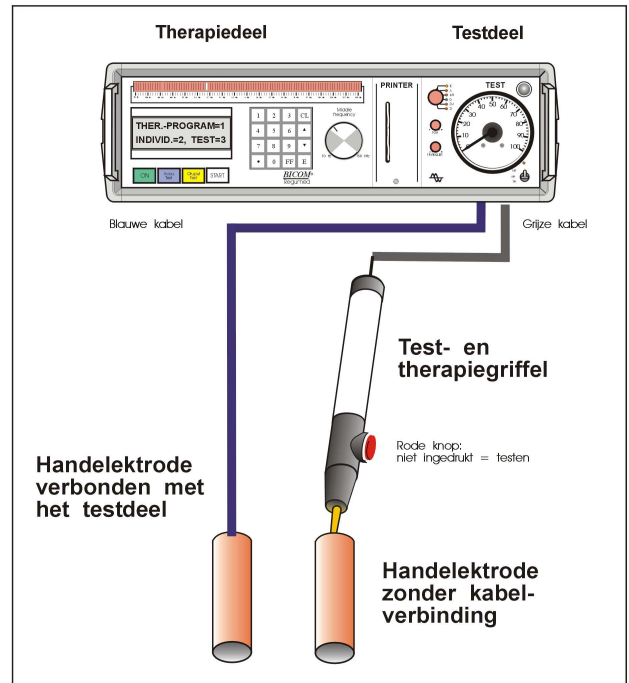

Hoe wordt de allergie test uitgevoerd?